


# 罗氏 LightCycler480 软件安装及卸载重装

软件安装大致流程：


- 1、运行安装包，需注意修改“Software”及“Exor4”安装路径
- 2、（重要）安装完成后需将安装包内“Data-HTC1.sxc”文件移至安装目录下

## 一、软件安装


双击打开  LightCycler480\_Software\_Setup

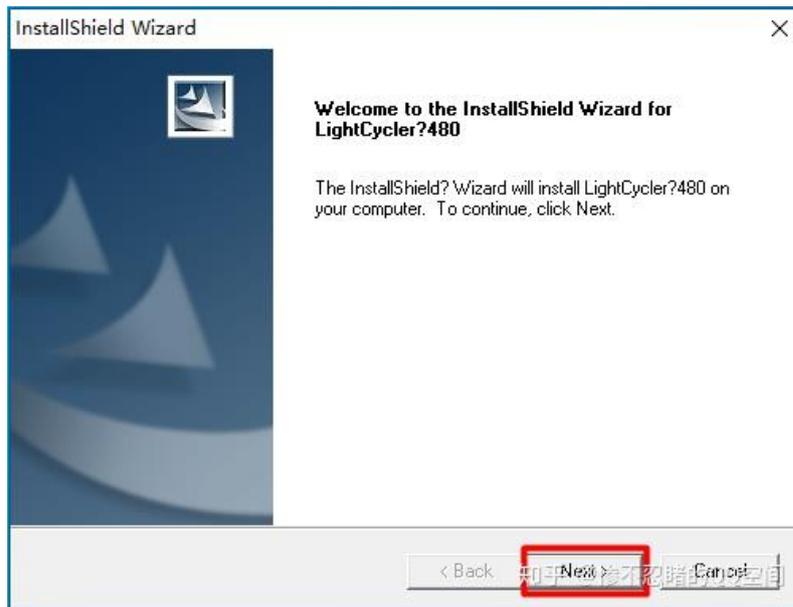


第一步：Next

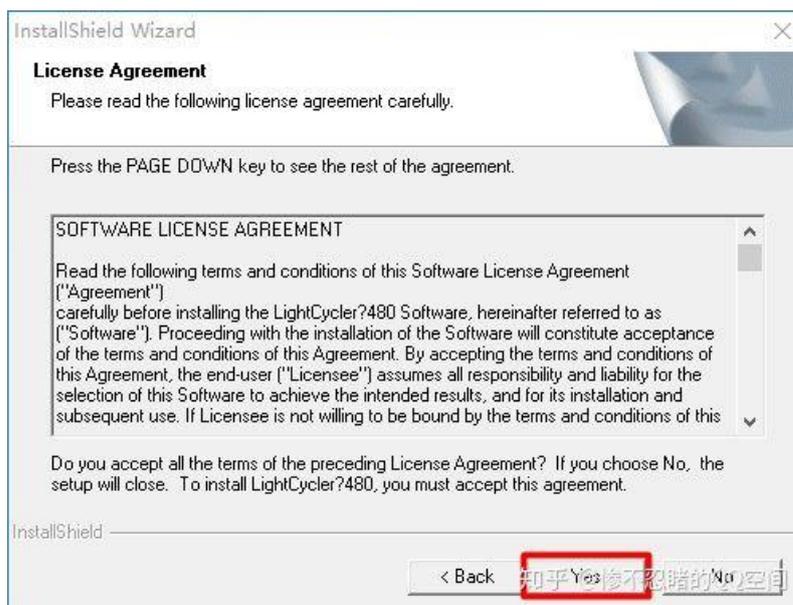


第二步：Yes

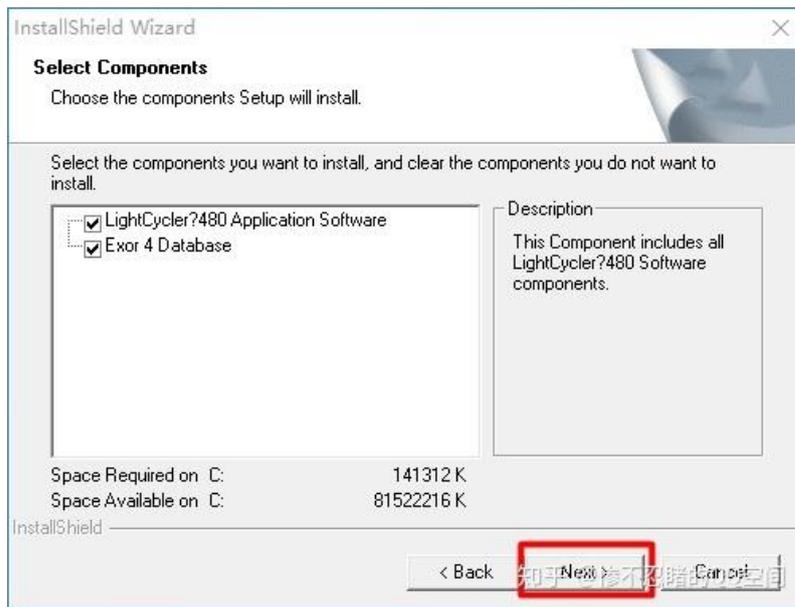


第三步：默认选项，不做修改。Next

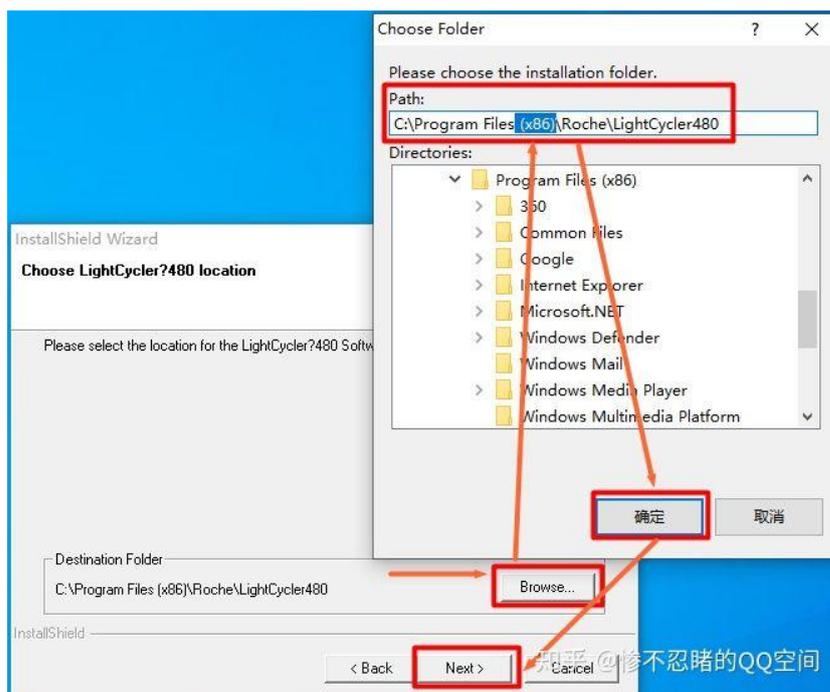


第四步：需修改安装路径，仅将安装路径中“(x86)”删除，注意空格也需删除

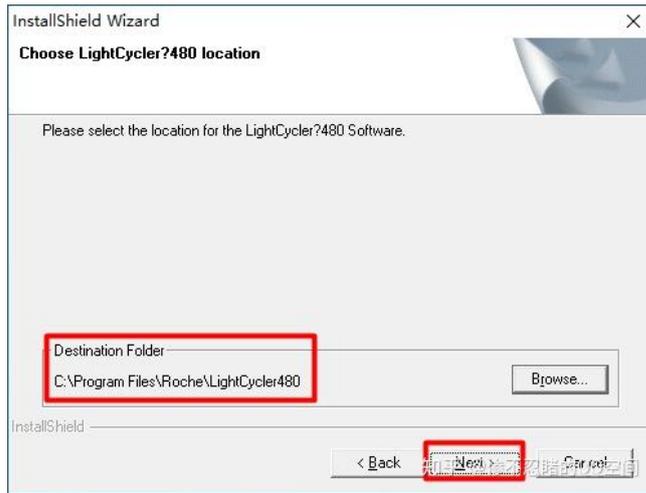


第四步修改后状态，Next

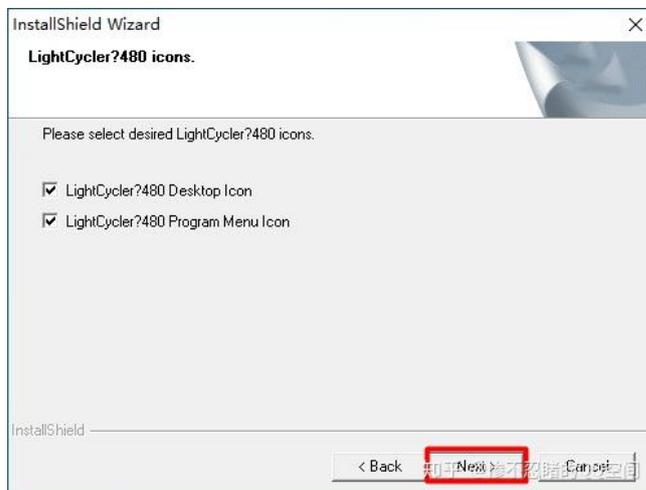


第五步：默认选项，不做修改。Next

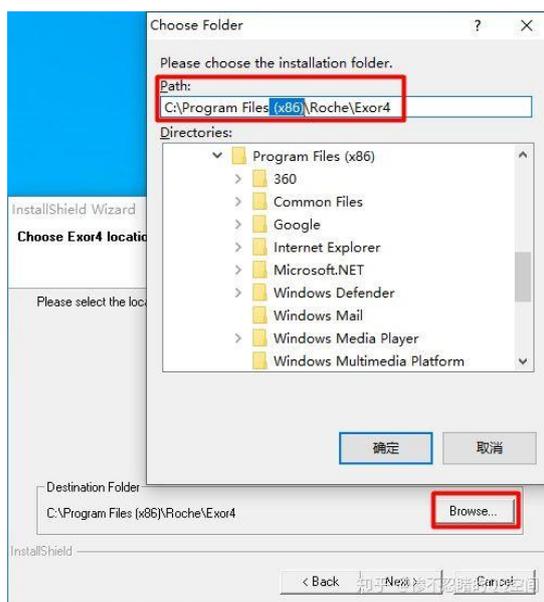


第六步：同第四步一样，仅将安装路径中“(x86)”删除，注意空格也需删除。Next

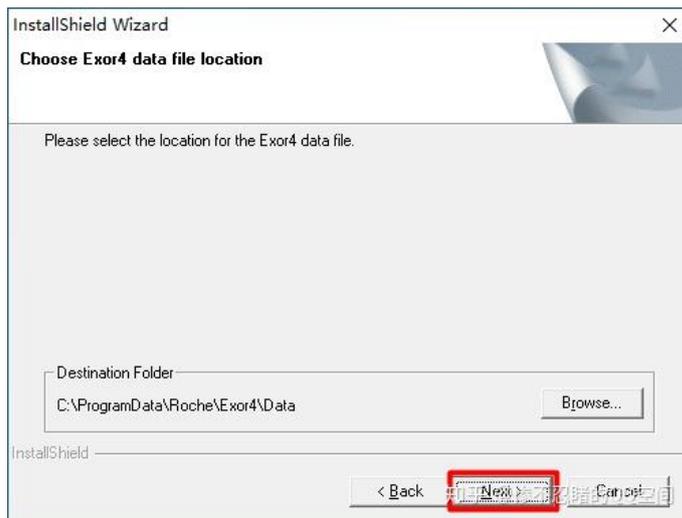


第七步：默认路径，不做修改。Next

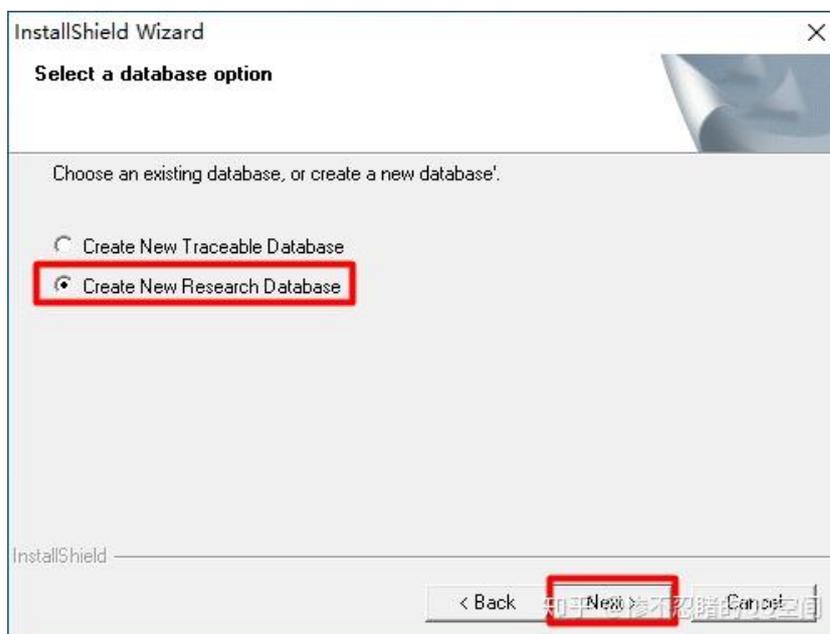

第八步：选择第二项 创建 Research 数据库，Next

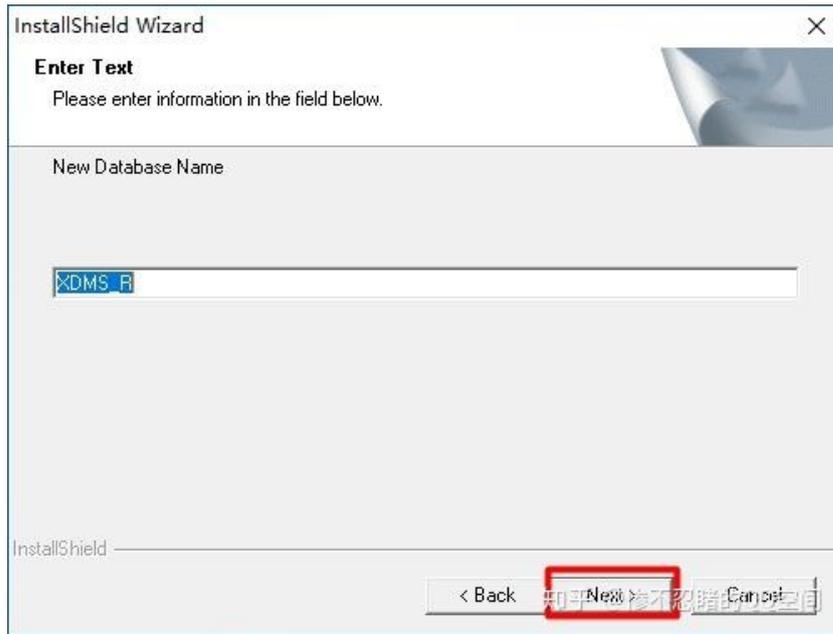

第九步：默认数据库名称，不修改。Next

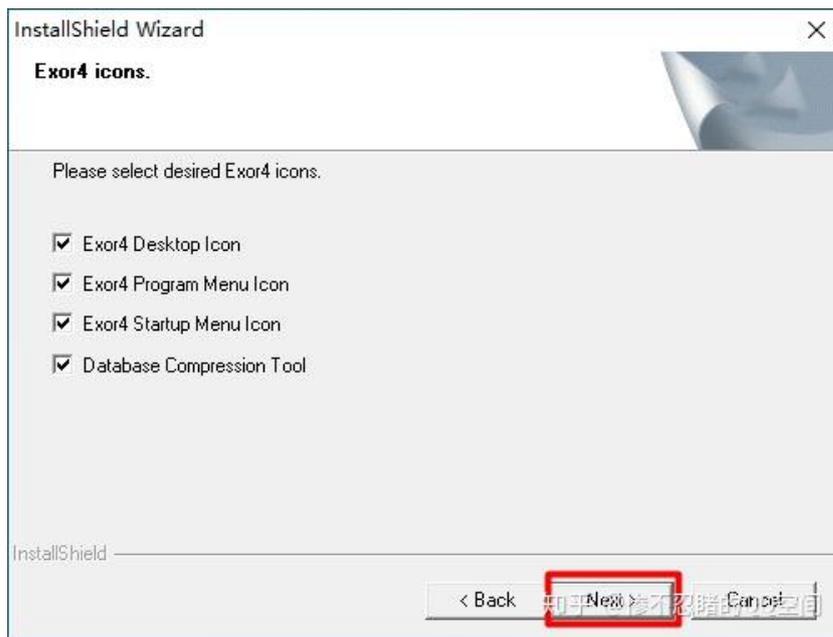


第十步：默认选项，不修改。Next 后自动安装



安装完成后，检测到无 Adobe Read 软件，需点“是”安装。如果已经安装了 PDF 阅读器，点否（NO）

Adobe Read 安装过程依次点击“Next-Install-Finsh”即可。

Adobe Read 完成后，注意保存正在编辑的文档。跳出的安装界面选择第一项，重启电脑。

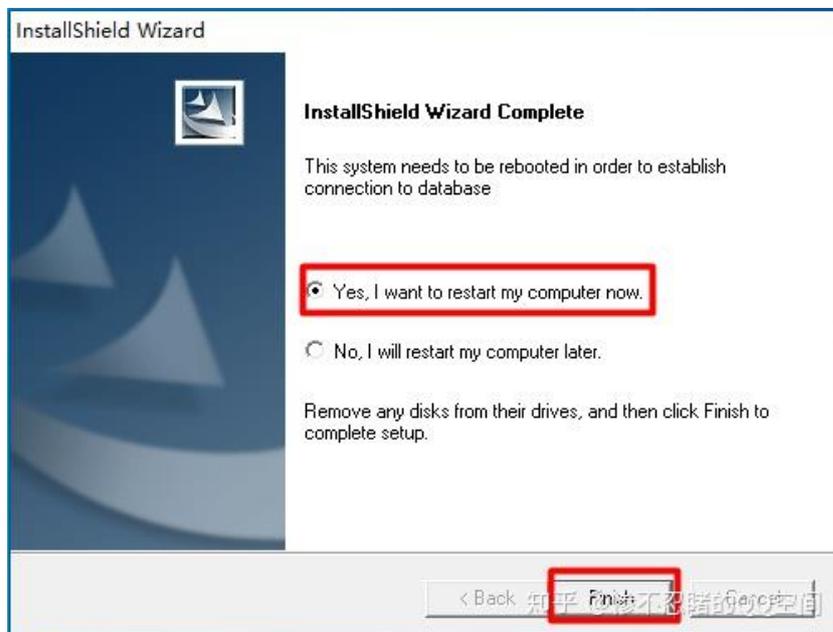


跳出 480 安装完成界面。重启电脑。



重启电脑后，开机自动运行 Exor，提供数据库服务


### 第十一步（重要）：复制文件至安装目录

① 打开安装包内的 Data 文件夹，将“HTC1.sxc”复制到“C:\Program Files\Roche\LightCycler480\Bin”目录下。

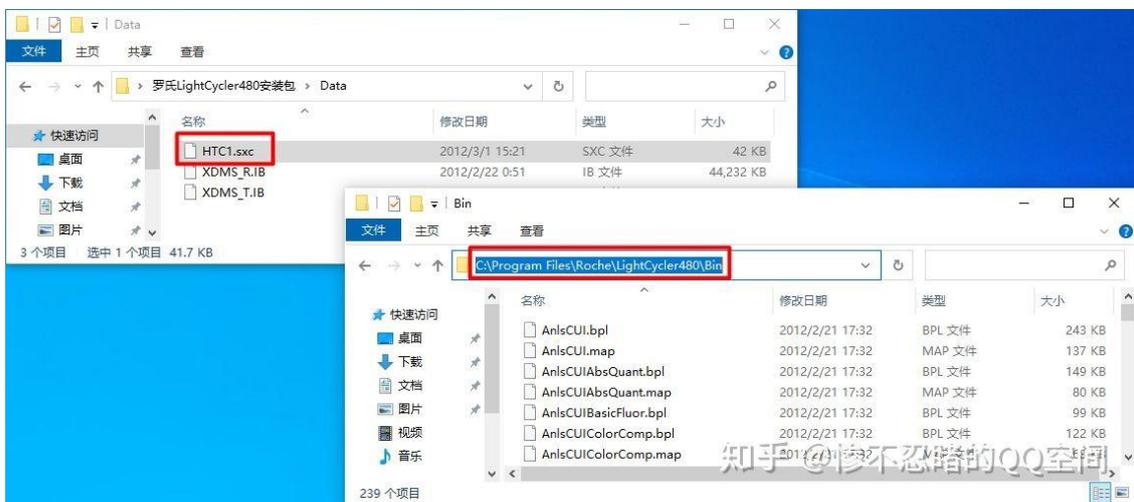

至此，软件即可正常打开使用

②在“C:\Program Files\Roche\LightCycler480\Bin”目录下找到 HTC1 图标，单击右键、发送至桌面快捷方式，方便以后打开使用。安装后图标为 

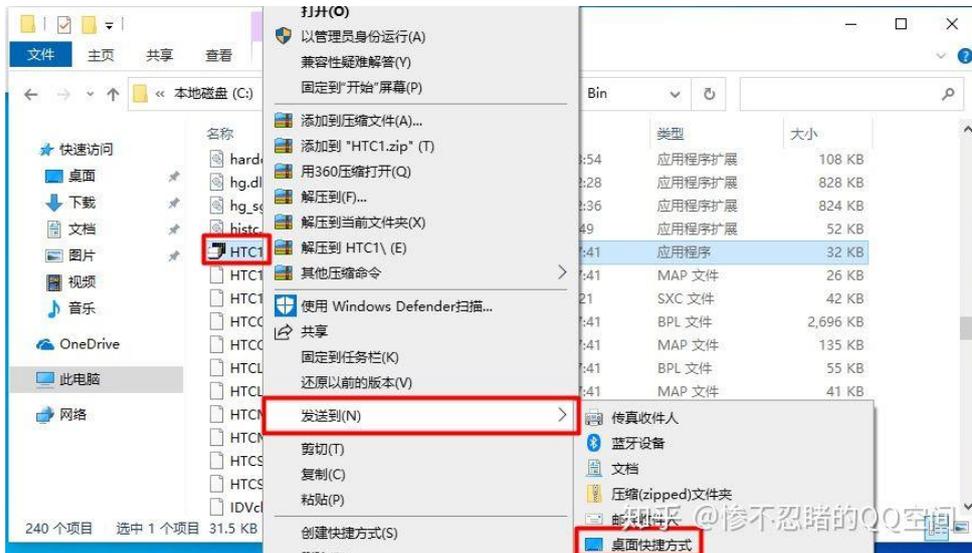


## 第十二步：软件登录连接

1. 打开软件，输入初始用户名：admin， 密码：LightCycler480
2. 设置连接虚拟机：



- ①进入软件后点右侧  图标
- ②选择Instruments（下图红框圈出的地方）
- ③选择虚拟机Virtual LightCycler 480 96 System II（下图红框圈出的地方）
- ④点击Test connection，稍等一会提示连接成功
- ⑤点击右下角Make Default（上图红框圈出的地方），然后点close即连接完成。软件连接完成后，可以模拟真机进行操作。

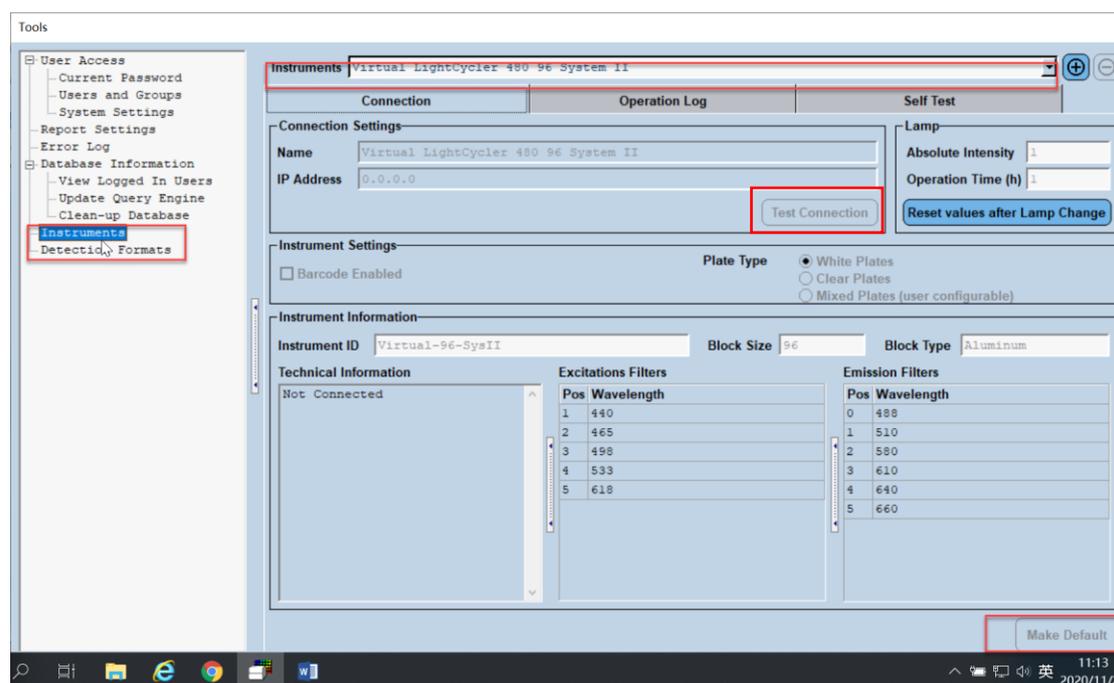

## 二、其他注意事项及可选配置

在不每天都使用 480 软件时，建议关闭 Exor4 软件的开机自启，会占用一定系统资源。

关闭方法：


- 对桌面底端任务栏空白处单击鼠标右键、打开任务管理



或按键盘 Ctrl+Alt+Delter 点开详细信息，找到“启动”菜单



首次打开任务管理器，需点开详细信息

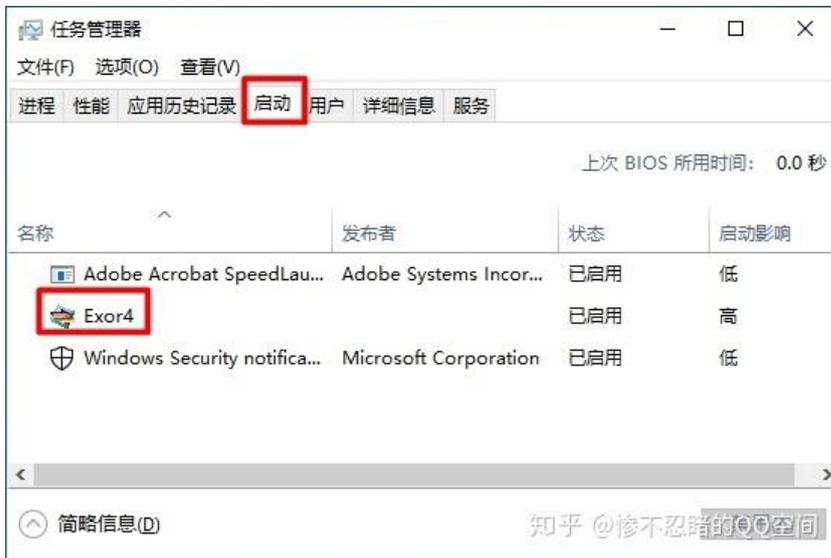

点开“启动”菜单，找到 Exor4

对 Exor4 单击鼠标右键，选择禁用。



开启 Exor4 的开机自启方法同理。


### 三、软件卸载后无法重装问题及解决方法

在软件安装时错误选择安装目录会导致安装失败，软件卸载后重新安装软件时会弹出如下报错：



出现报错截图，导致无法继续安装

解决方法：

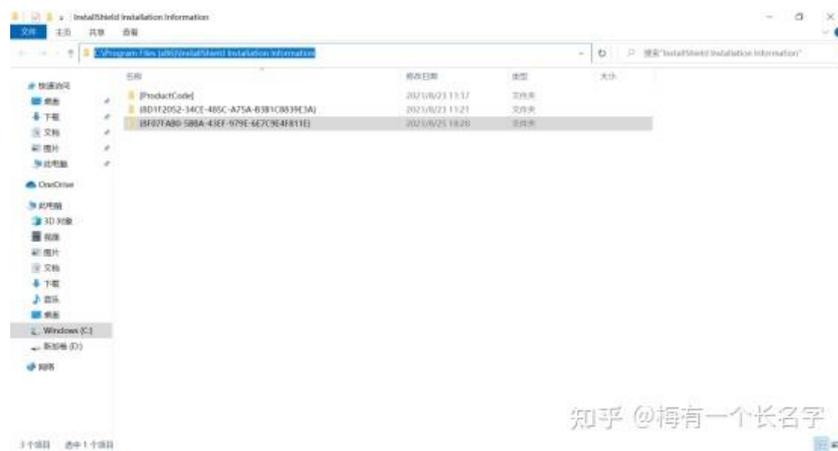

打开资源管理器，进入目录

C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information



将 {8F07FAB0-5BBA-43EF-979E-6E7C9E4F811E} 文件夹删除，即可重新运行安装程序

注意事项：

此方法安装完后，Exor 提供的端口（默认为 20481）号可能会变更。在软件登陆时需注意修改端口号。